COLO.SCIENCE | TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

PDF DOKUMENT | ZATRAŽI PONUDU | PREGLED VAGA | KATALOG VAGA | ANALITIČKE VAGE


SIENE serija

Analitička vaga | kapacitet 30-500 g | čitljivost 0,01-0,1 mg | interna kalibracija

SIENE analitička vaga je laboratorijska vaga sa ekranom osetljivim na dodir za zahtevna merenja sa rezolucijom 0,01-0,1 mg u opsegu od 30 do 500 g. Izvorna specifikacija navodi internu kalibraciju, temperaturnu kompenzaciju, filter vibracija, RS232 / USB izlaz, rad preko LCD ekrana osetljivog na dodir sa pozadinskim osvetljenjem i tas od 80 mm.

30-500 G | ČITLJIVOST 0,01-0,1 MG | INTERNA KALIBRACIJA | TEMPERATURNA KOMPENZACIJA | FILTER VIBRACIJA | RS232 / USB | EKRAN OSETLJIV NA DODIR | TAS 80 MM

Tip dokumenta: **List tehničke specifikacije**
Familija proizvoda: **SIENE analitička vaga**
Kapacitet: **30-500 g**
Kalibracija: **Interna kalibracija**
Karakteristika serije: **analitičko merenje sa rezolucijom 0,01-0,1 mg i radom preko ekrana osetljivog na dodir**
Format: **A4 pejzaž | COLO.Science TechSpec v2.5**

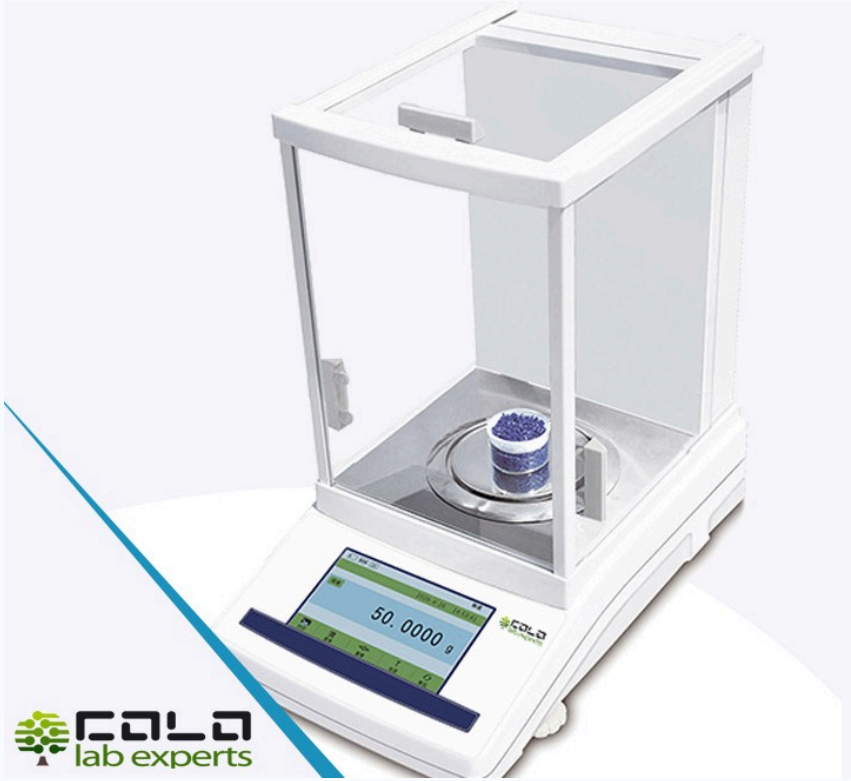

ANB-SIENE analitička vaga | ekran osetljiv na dodir | interna kalibracija | stakleni vetrobran

MERNI OPSEG
30-500 g
d = 0,01-0,1 mg

ADRESA / SEDIŠTE
Branka Radičevića 1
21000 Novi Sad, Srbija

KONTAKT
sales@colo.si
+381 64 659 14 21

SIENE | analitička vaga

Interna kalibracija, čitljivost 0,01-0,1 mg i rad preko ekrana osetljivog na dodir

MAKS. 500 G | D = 0,01-0,1 MG | INTERNA KALIBRACIJA | RS232 / USB IZLAZ

Merenje visoke preciznosti za zahtevna analitička merenja

Pregled serije

Kalibracija, stabilnost i rukovanje

Interna kalibracija: obezbeđuje brzu i veoma preciznu kalibraciju u radu sa analitičkom vagom.

Temperaturna kompenzacija: doprinosi stabilnim merenjima u uobičajenim laboratorijskim uslovima.

Filter vibracija: pomaže da se smanji uticaj vibracija iz okoline na merenja sa rezolucijom 0,01-0,1 mg.

Rad preko ekrana osetljivog na dodir: LCD sa pozadinskim osvetljenjem i ekranom osetljivim na dodir za jednostavno podešavanje merenja.

Obrada podataka i upotrebljivost

Rad sa podacima na računaru: opcioni komunikacioni softver može da prikuplja podatke i upravlja procesom merenja.

Izlaz na poziciju kursora: rezultati merenja mogu se upisivati u Excel, Word i druge dokumente na mestu kursora.

Ekran u boji osetljiv na dodir: direktan pristup čestim podešavanjima preko LCD ekrana visoke rezolucije osetljivog na dodir.

Ugrađeni zapisi: prikaz datuma, vremena i temperature može se podesiti radi sledivih postupaka merenja.

Ključne karakteristike proizvoda iz izvorne tabele

Opseg modela: PRO7036-PRO7040, od 30 g do 500 g.

Čitljivost: 0,01 mg za model 30 g; 0,1 mg za modele 120-500 g.

Ponovljivost: ±0,05 mg za 30 g; ±0,2 mg za modele 120-500 g.

Linearnost: ±0,03 mg za 30 g; ±0,2 mg za modele 120-500 g.

Izlaz: RS232 / USB komunikacioni interfejs.

Tas: Ø80 mm za ove analitičke modele.

MODELI	ČITLJIVOST	MERNA KOMORA	STABILIZACIJA
30-500 g	0,01-0,1 mg	360 x 210 x 320 mm	3 s

Modeli i tehnička specifikacija

Izbor modela i vrednosti iz izvorne tabele

SKU	Model	Merni opseg	Čitljivost	Ponovljivost	Linearnost	Kalibracija	Izlazni interfejs
PRO7036	**ANB-SIENE 30g/0.01 mg**	30 g	0,01 mg	±0,05 mg	±0,03 mg	Interna	RS232 / USB
PRO7037	**ANB-SIENE 120g/0.1 mg**	120 g	0,1 mg	±0,2 mg	±0,2 mg	Interna	RS232 / USB
PRO7038	**ANB-SIENE 220g/0.1 mg**	220 g	0,1 mg	±0,2 mg	±0,2 mg	Interna	RS232 / USB
PRO7039	**ANB-SIENE 320g/0.1 mg**	320 g	0,1 mg	±0,2 mg	±0,2 mg	Interna	RS232 / USB
PRO7040	**ANB-SIENE 500g/0.1 mg**	500 g	0,1 mg	±0,2 mg	±0,2 mg	Interna	RS232 / USB

Merni sistem i performanse


Parametar	Specifikacija
Merni opseg	30 / 120 / 220 / 320 / 500 g
Čitljivost	0,01 mg / 0,1 mg, zavisno od modela
Ponovljivost	±0,05 mg za 30 g; ±0,2 mg za 120-500 g
Linearnost	±0,03 mg za 30 g; ±0,2 mg za 120-500 g
Stabilizacija	3 s
Režimi merenja	Osnovno merenje, brojanje komada, procentualno merenje, određivanje gustine, merenje praha
Opseg tare	Ceo opseg

Displej, interfejs i konstrukcija

Parametar	Specifikacija
Displej	LCD sa pozadinskim osvetljenjem, ekran osetljiv na dodir
Interfejs	RS232 / USB
Veličina tasa	Ø80 mm
Zahtevi za napajanje	Ulaz adaptera: 100-240 V ~ 200 mA, 50-60 Hz; izlaz: 5 VDC 2,5 A
Ukupne dimenzije	360 x 210 x 320 mm
Neto / bruto masa	5 kg / 7,3 kg
Dimenzije pakovanja	50 x 36 x 47 cm

Napomena o izvoru: Vrednosti modela/SKU i merni opsezi ažurirani su prema dostavljenoj SIENE listi modela i tehničkoj tabeli. Ostale SIENE karakteristike usklađene su sa postojećim šablonom tehničke specifikacije.

Primene, isporuka, opcije i kalibracioni tegovi

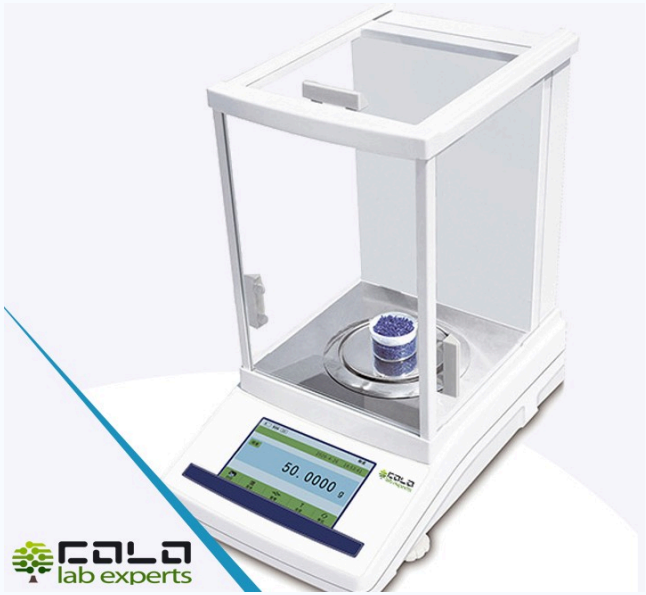

SIENE analitička vaga | interna kalibracija | ekran osetljiv na dodir | čitljivost 0,01-0,1 mg

Ugrađene aplikacije i režimi rada

Standardno analitičko merenje: merenje laboratorijskih uzoraka visoke preciznosti.

Brojanje komada: brojanje do 1 mg u laboratorijskim uslovima; minimalna masa 10 mg, rezolucija brojanja 210.000.


Procentualno merenje: poređenje izmerene mase sa referentnom.

Određivanje gustine: funkcija direktnog očitavanja gustine uz opcioni hidrostatički set.

Merenje životinja: omogućava merenje nestabilnih uzoraka.

Kontrolno i ciljno merenje: provera gornje/donje granice, merenje do ciljne vrednosti, sabiranje, bruto/neto/tara i zadržavanje maksimalne vrednosti.

Opcioni pribor

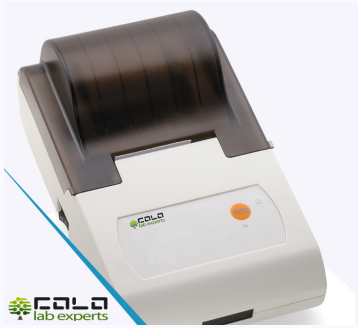

Opcioni termalni štampač za laboratorijsku vagu



Opcioni OIML E2 kalibracioni / kontrolni teg

Napomena o poručivanju: izvorni PDF preporučuje kalibracioni/kontrolni teg od 200 g klase E2. Potvrdite potrebne nominalne mase, E2 sertifikate i postupak kalibracije/kontrole tegom za izabrani model SIENE i laboratorijski SOP.

PRODAJA I PODRŠKA

COLO Science Novi Sad

Branka Radičevića 1, 21000 Novi Sad, Srbija

Pomoć pri izboru: Pošaljite predviđeni merni opseg, tip uzorka, minimalnu masu uzorka, zahteve za štampač/izlaz podataka, postupak kalibracije i očekivanu dokumentaciju.

BRZI KONTAKT

Web: colo.si/sr/pocetna

E-pošta: sales@colo.si

Telefon: +381 64 659 14 21

Serija: SIENE analitička vaga

COLO.SCIENCE | PODRŠKA ZA SIENE ANALITIČKE VAGE

Potrebna vam je pomoć pri konfigurisanju SIENE analitičke vage?

Pošaljite merni opseg, tip uzorka, rutinsku minimalnu masu, zahtev za štampu, način rada sa podacima na računaru i postupak kalibracije. COLO.Science može potvrditi SIENE konfiguraciju, štampač, softver i set E2 kalibracionih/kontrolnih tegova.

GLAVNA NAVIGACIJA ZA VAGE

Pregled vaga | Katalog vaga

KATEGORIJE VAGA

Analitičke vage | Miligramske vage | Precizne vage | OIML E2 tegovi

PONUDA I TEHNIČKA PODRŠKA

Zatraži ponudu | Kontaktirajte COLO.Science tim

Napomena o službenoj konfiguraciji: Ovaj dokument služi za orijentaciju i izbor proizvoda. Ne zamenjuje obavezujuću specifikaciju, isporučenu konfiguraciju, set pribora niti kriterijume prijema potvrđene u službenoj ponudi COLO.Science, profakturi, potvrdi porudžbine ili tehničkoj ponudi odobrenoj od proizvođača. Za konkretnu porudžbinu potvrdite konfiguraciju modela, postupak interne kalibracije, kalibracione/kontrolne mase, sertifikate, štampač, softver i pribor. Specifikacije se mogu menjati bez prethodne najave.